




ATTENTES NECESSAIRES A L'INSTALLATION DU LAVE-BASSINS ET RESERVATIONS A LA CHARGE DU CLIENT

EMPLACEMENT DES ATTENTES :

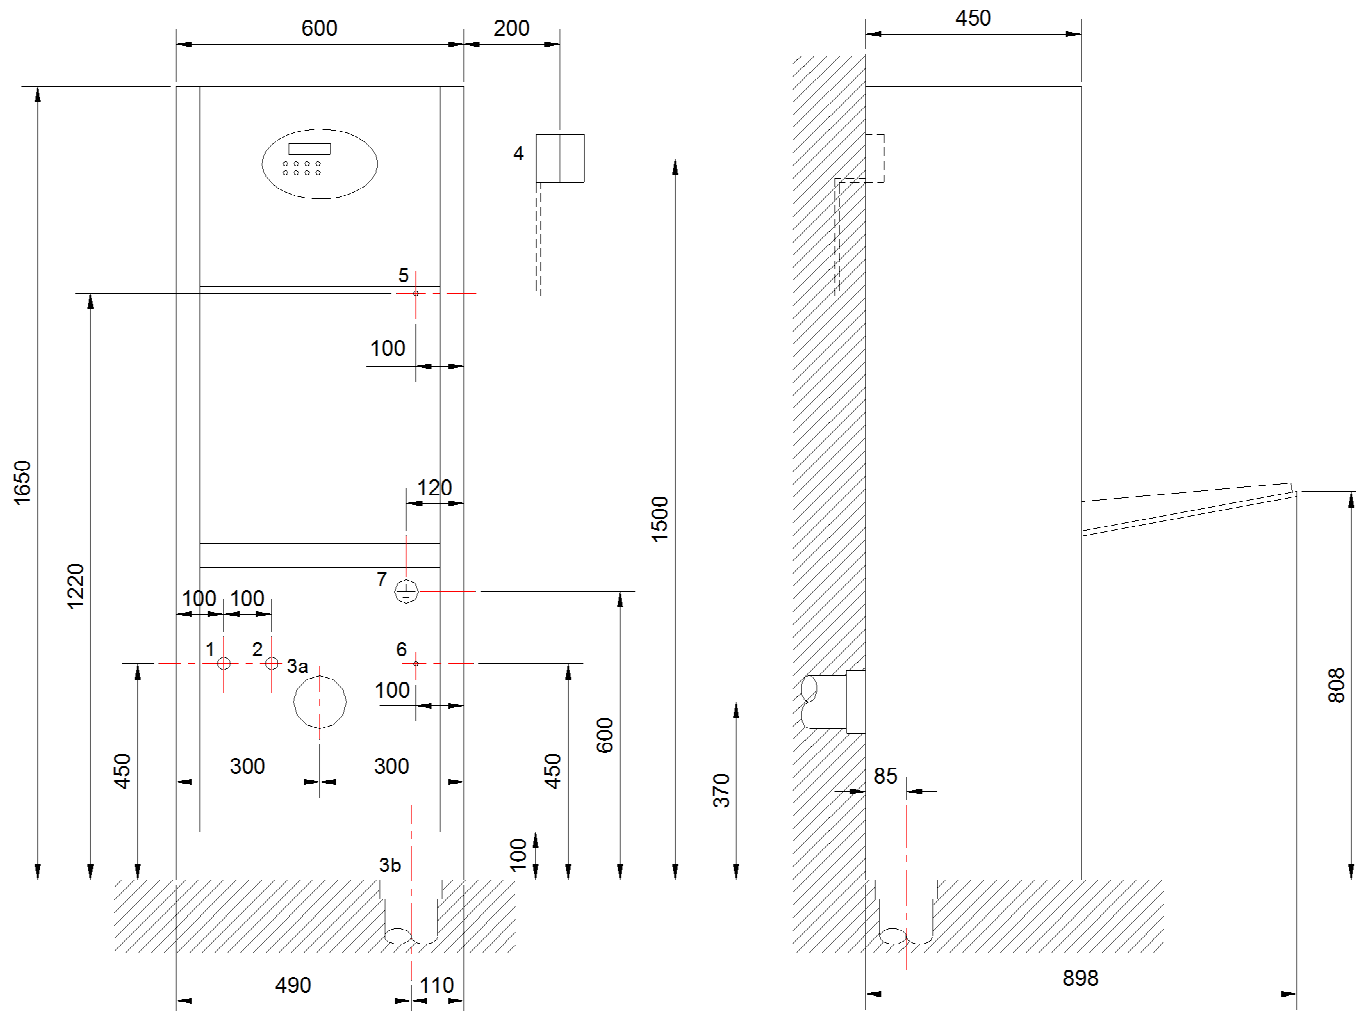

Repère n°1 : eau chaude, 3/4" mâle sur vanne d'arrêt, pression min. 0.7bar max. 6 bar, température entre 30 et 60°C.

Repère n°2 : eau froide, 3/4" mâle sur vanne d'arrêt, pression min. 0.7bar max. 6 bar.

Repère n°3a : Vidange au mur Ø110mm.

Repère n°4 : Interrupteur général omnipolaire magnétothermique.

Repère n°5 : Câble 3G2.5 pour alimentation électrique 230V 16A ou
Câble 5G2.5 pour alimentation électrique 400V ~ triphasé (3 phases + 1 neutre + 1 terre).

Repère n°6 : Prise pour connexion d'un ordinateur.

Repère n°7 : Mise à la terre.